

Poznań, dnia 11.12.2023 r.

SR/XV-270-26(26)-AG/23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 132 i nast. ustawy Pzp na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
SR/XV-270-26-AG/23

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 20

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 20:

Pytanie nr 1.

Pakiet nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla noworodków o pojemności 280ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 2.

Pakiet nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla noworodków z maską w rozmiarze 1?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 3.

Pakiet nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści resuscytator nie posiadający mediportu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 4.

Pakiet nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla dzieci o pojemności 550ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.



Pytanie nr 5.

Pakiet nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla dzieci z maską w rozmiarze 2?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 6.

Pakiet nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści resuscytator nie posiadający mediportu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 7.

Pakiet nr 1, pozycja 4-6

Czy Zamawiający dopuści maskę do resuscytacji o anatomicznym kształcie, wykonaną z PCV, bez lateksu i ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 8.

Pakiet nr 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści maskę do resuscytacji dla noworodków o szerokości 5,5cm i długości 8,5cm (+/-1cm)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9.

Pakiet nr 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści maskę do resuscytacji dla niemowląt o szerokości 6,5cm i długości 10,0cm (+/-1cm)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10.

Pakiet nr 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści maskę do resuscytacji dla dzieci o szerokości 7,5cm i długości 11,5cm (+/-1cm)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 11.

Pakiet nr 6, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czysty czujnik?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12.

Pakiet nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czujnik nie posiadający wbudowanego układu pamięci?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 13.

Pakiet nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania prawidłowej identyfikacji nazwy handlowej czujnika przez monitor?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 14.

Pakiet nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści w zamian za oświadczenie producenta oryginalnych czujników – oświadczenie producenta zamiennych czujników o kompatybilności czujników z monitorem Oximax?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 15.

Pakiet nr 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czujnik wykonany z włókniny samoprzylepnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 16.

Pakiet nr 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czujnik dla niemowląt o wadze poniżej 3kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.



Pytanie nr 17.

Pakiet nr 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czujnik na stopę z kształcie litery L?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 18.

Pakiet nr 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści w zamian za oświadczenie producenta oryginalnych czujników – oświadczenie producenta zamiennych czujników o kompatybilności czujników z monitorem Oximax?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 19.

Pakiet nr 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej z bezalkoholowym płynem do płukania ust z 0,12% roztworem chlorheksydyny, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20.

Pakiet nr 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej z bezalkoholowym płynem do płukania ust z 0,1% nadtlkiem wodoru, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21.

Pakiet nr 14, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej z bezalkoholowym płynem do płukania ust z 0,1% nadtlkiem wodoru, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 22.

Pakiet nr 14, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek do mycia głowy z możliwością podgrzania w kuchence mikrofalowej do 20 sekund przy mocy 700W?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23.

Pakiet nr 14, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek do mycia głowy zarejestrowany na 23% stawce podatku vat?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 24.

Pakiet nr 16, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wziernik uszny o średnicy 2,5mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 25.

Pakiet nr 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ustnik do gastrokopii o wymiarach 21 x 26,5mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 26.


Pakiet nr 32, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści równoważne okulary do fototerapii o następujących parametrach:

- jednoczęściowe
- wykonane z pianki poliuretanowej, weluru i bawełny
- wąska opaska na głowę wykonana z tego samego materiału co osłona na oczy
- osłona na oczy z podwójnego materiału
- wygodne zapięcie na rzepy z możliwością wielokrotnej zmiany pozycji, dające możliwość dostosowania rozmiaru (mocowanie główne z tyłu głowy + dodatkowe mocowanie stabilizujące z boku głowy (przechodzące przez czubek))
- dostępne w 3 rozmiarach: S- obwód max. – 31cm, M- obwód max. 35 cm, L- obwód max. 40 cm
- rozstaw: ok. 4 cm (S), ok. 5,5 cm (M), ok. 7,5 cm (L)
- bez lateksu



- zdjęcie poglądowe poniżej:

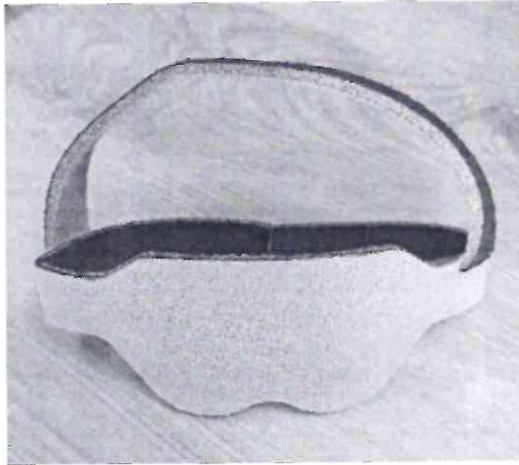

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 27.

Pakiet nr 59 pozycja 1

Czy Zamawiający doprecyzuje czy wymaga szczotki suchej czy nasączonej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga szczotki suchej.

Pytanie nr 28.

Pakiet nr 65, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu o pojemności całkowitej 2500ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 29.

Pakiet nr 65, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu o pojemności worka 2000ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 30.

Pakiet nr 65, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu z komorą kroplową o pojemności 500ml?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 31.

Pakiet nr 65, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści komorę kroplową z 2 skalami: do 50ml co 1ml oraz co 5ml od 50ml do 500ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 32.

Pakiet nr 65, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu z opróżnianiem komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 33.

Pakiet nr 65, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu z drenem o długości 120cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 34.

Pakiet nr 65, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu z drenem antyzagięciowym, ale nie posiadającym pasków przeciw zgięciowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 35.

Pakiet nr 65, pozycja 2


Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu posiadający wyłącznie bezigłowy port do pobierania próbek moczu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 36.

Pakiet nr 65, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu nie posiadający instrukcji obsługi?



Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 37.

Pakiet nr 65, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu pakowany sterylnie w opakowanie folia-papier?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 38.

Pakiet nr 65, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wieszak na worki bez uchwytu na węzyk?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 39.

Pakiet nr 68, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca o parametrach:

- Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm
- Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika
- Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo
- Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący
- Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną
- Wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka
- Sterylny
- Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe
- Zestaw zawiera: cewnik, 1x worek, 1x strzykawkę 60ml, 2x przyklepne opatrunki
- Wymienny worek pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 40.

Pakiet nr 68, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga sterylnego zestawu do kontrolowanej zbiórki stolca?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 41.

Pakiet nr 68, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem


DIREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
lecz. med. Elżbieta Wrzesińska-Zak

