

Poznań, dnia 25.03.2024 r.

SR/XV-270-6(9)-AG/24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na sukcesywną dostawę drobnego, jednorazowego, jałowego sprzętu medycznego do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu

SR/XV-270-6-AG/24


ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 7

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 7:

1. Pytanie dotyczy pakietu 4, pozycja 1:


Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznej igły do portu, z elastycznymi skrzydełkami, dostosowana do podawania kontrastu ze wstrzykiwaczy ciśnieniowych (odporna na działanie ciśnienia 300psi), igła z klipsem zatraskowym na drenie z oznaczeniem wartości przepływów w ml/s, igła posiadająca system zabezpieczenia ostrza chroniący personel przed zakłuciem. W opakowaniu dodatkowo naklejka z oznaczeniem przepływu dla ułatwienia identyfikacji zastosowania igły w pracowni CT, w opakowaniu zbiorczym po 20sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości. Prosimy o dopuszczenie rozmiarów: 19G x 19mm, 19Gx 25mm, 20G x 19mm, 20G x 25mm, 22G x 19mm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

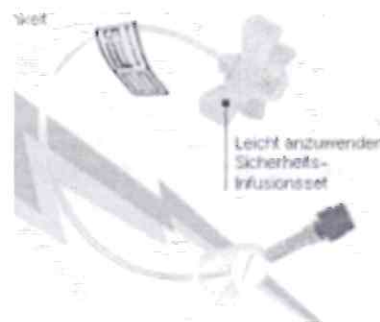

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.



2. Pytanie dotyczy pakietu 4, pozycja 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły bezpiecznej, z okrągłą płytką do mocowania, o średnicy około 30mm- posiadająca zabezpieczenie ostrza. Igła dostosowana do możliwości podawania kontrastu ze wstrzykiwaczy ciśnieniowych (odporna na działanie ciśnienia 325psi) z oznaczeniem przepływu w ml/s na klipsie zatraskowym, dodatkowo w opakowaniu naklejka z oznaczeniem przepływu ułatwiająca identyfikację możliwości zastosowania igły. Igła z przezroczystą podstawą stabilizującą z miękką pianką, poprawiającą komfort pacjenta w trakcie użytkowania, igła z drenem z klipsiem zatraskowym. Produkt sterylizowany EO, nie zawierający lateksu i DEHP. Igła w rozmiarze 20 Ga x 19 mm. Pozostałe zgodnie z SWZ

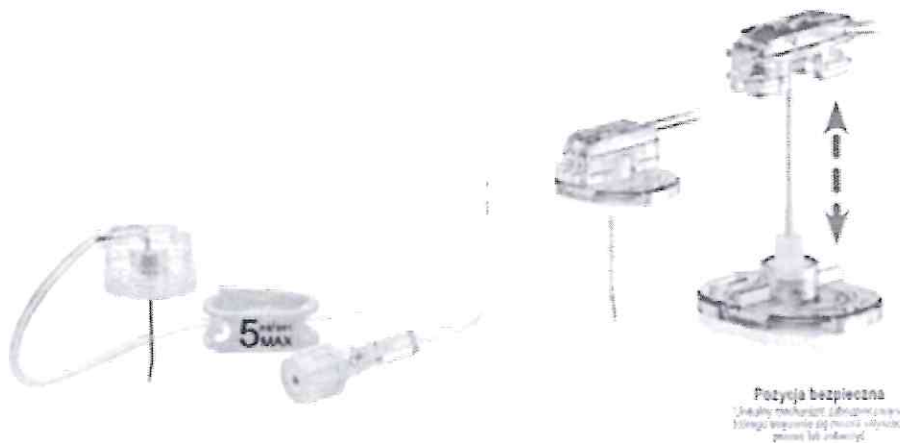

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

3. Prosimy o możliwość złożenia próbek do pakiet 4 poz 1 - tj. 1 sztuki w jednym dowolnym rozmiarze wymaganym przez Zamawiającego ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

4. W przypadku niezgodności w pakiecie 4 sposobu pakowania podanego przez Zamawiającego , prosimy o możliwość odpowiedniego sposobu przeliczenia tj . zaokrąglając do pełnych opakowań w górę.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem


DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei

lek. med. Elżbieta Winiarska-Łaźnik