

SR/XV-270-16(21)-AG/25

Poznań, dnia 24.07.2025 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy Pzp na sukcesywną dostawę drobnego, jednorazowego, jałowego sprzętu medycznego do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu

SR/XV-270-16-AG/25

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 18

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 18:

Do umowy:

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 7, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze CH20?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.


Pakiet 7, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze CH21?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 7, pozycja 12-17

Czy Zamawiający dopuści dren do klatki piersiowej z trokarem innego producenta, posiadający 2 otwory boczne naprzemianległe zapobiegające aspiracji i wrastaniu tkanek jak na poniższym zdjęciu?



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 7, pozycja 12-17

Czy Zamawiający dopuści dren do klatki piersiowej z trokarem pakowany podwójnie w opakowanie folia + papier/folia?



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 7, pozycja 20-22

Czy Zamawiający dopuści łyżki laryngoskopowe światłowodowe jednorazowe, metalowe z plastikową stopką o poniższych właściwościach:

- Zaokrąglona końcówka łyżki i gładkie krawędzie zapewniają delikatny dotyk na tkanki miękkie pacjenta.
- Specjalnie obniżony profil łyżek ogranicza ryzyko uszkodzenia zębów podczas intubacji.
- Zatrask kulkowy zintegrowany w zielonej stopce.
- Wyrób nie zawiera lateksu, bezpieczny w użyciu.
- Światłowod z tworzywa sztucznego: Akrylowy o średnicy 5 mm zapewnia jasne i maksymalne oświetlenie.
- Światłowod nieosłonięty doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło.
- Kompatybilna ze wszystkimi rękojeściami laryngoskopowymi według zielonego oznaczenia (green system) zgodnymi z normą ISO 7376/3.
- Oznakowanie na grzbiecie łyżek: logo producenta, typ, rozmiar, znak CE oraz symbol „nie do powtórnego użycia” - dodatkowe oznaczenie na stopce "SINGLE USE"
- Czyste mikrobiologicznie.
- Opakowanie foliowe.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 7, pozycja 20-22

Czy Zamawiający dopuści łyżki laryngoskopowe występujące wyłącznie w poniższych rozmiarach?

Światłowod Akrylowy		
Numer REF	Rozmiar	Długość
1801-000E	000	58 mm
1801-00E	00	68 mm
1801-0E	0	80 mm
1801-1E	1	95 mm
1801-2E	2	105 mm
1801-3E	3	135 mm
1801-4E	4	155 mm
1801-5E	5	175 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 7, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną małą dla dorosłych w rozmiarze 3 z pierścieniem w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.


Pakiet 7, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną średnią dla dorosłych w rozmiarze 4 z pierścieniem w kolorze czerwonym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 7, pozycja 26-29

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową jak na poniższym zdjęciu:

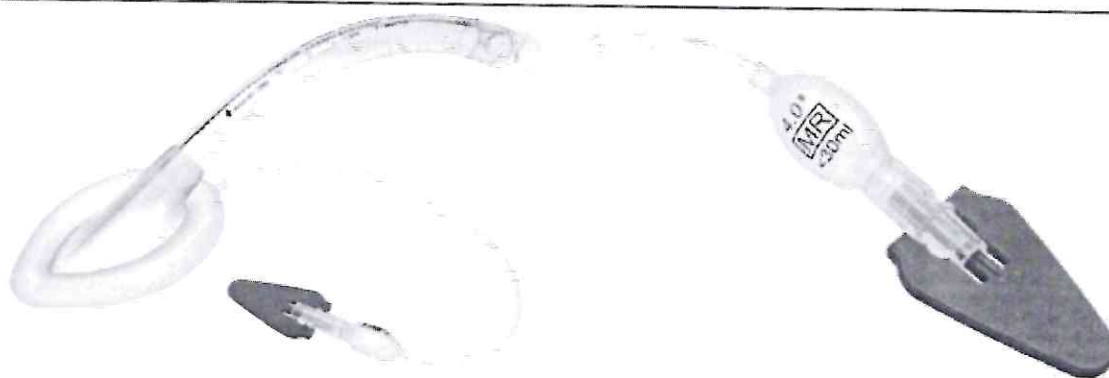

?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 7, pozycja 26-29

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową wyłącznie o poniższych właściwościach:

- Wykonana z medycznego PVC
- Kompatybilna z rezonansem magnetycznym (MR), brak metalowych elementów
- Przezroczysty, elastyczny mankiet uszczelniający o eliptycznym kształcie, zapewnia bezpieczną kontrolę oddychu
- Anatomicznie wyprofilowany korpus maski z oznaczeniem przedziału wagowego pacjenta, objętości mankieta, ciśnienia wypełnienia mankieta oraz rozmiaru
- Uniwersalny, przezroczysty łącznik 15 mm
- Przezroczysty balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru maski, maksymalnej objętości mankieta oraz kompatybilności z (MR) rezonansem magnetycznym
- Barwione kolorystycznie zabezpieczenie zastawki
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka / papierfolia

?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 7, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową w rozmiarze 5 (70-100kg)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 7, pozycja 32-33

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych z aluminium pokrytego PCV?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 7, pozycja 32-33

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych w rozmiarach:

10 Fr	3,3 mm	390 mm (±10)	350 mm (±5)	od 4,5 do 6,5
14 Fr	4,7 mm	320 mm (±10)	355 mm (±5)	od 7,0 do 10,0

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Pakiet 7, pozycja 35

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do trudnych intubacji w rozmiarze 3,3mm o długości 600mm lub 800mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ostrza chirurgiczne Producenta Swann-Morton?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści jałowy skalpel bez opakowania zmieniającego kolor w momencie utraty sterylności produktu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści żel pakowany pojedynczo, spełniający pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 12, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści cewniki z otworami naprzeciwległymi, spełniające pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 12, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści cewniki wykonane z wysokiej jakości medycznego pcv, spełniające pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 12, pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 4-światłowej silikonowej sondy Sengstaken – Blakemore o długości 85cm, z prowadnicą, wyposażoną w gąbkową podkładkę umożliwiającą zamocowanie w nozdrzach oraz zaciski na drenach umożliwiające łatwiejsze otwieranie i zamykanie linii do manometru. Numeryczne znaczniki głębokości od początku balonu przełykowego na 25, 30, 35, 40, 45, 50cm. Balony: żołądkowy o długości 60mm i przełykowy 140mm. Otwory boczne: 3 żołądkowe i 2 przełykowe?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 12, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dren z przedłużką wykonaną z silikonu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 12, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści kankę CH22 o średnicy 7,3mm lub CH24 o średnicy 8,0mm? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Pakiet 12, pozycja 13

Czy Zamawiający oczekuje zestawu do drenażu niskociśnieniowego czy wysokociśnieniowego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 12, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści zestaw spełniający wyłącznie poniższe parametry:

Skład zestawu:

1. Pojemnik szący typu płaski mieszek:
 - pojemność 250ml,
 - skalowany co 40ml,
 - zastawka antyzwrotna oraz zawór bezpieczeństwa typu SAVE umożliwiający wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu na poziomie 120mbar
 - wykonany z polietylenu
 - miękki o wysokiej rozprężności
 2. Dreny łączące z klamrami zaciskowymi:
 - Połączenie mieszek-dren Redona o długości 130cm z uniwersalnym zakończeniem do drenów Redona CH12-CH36
 - Połączenie Large-Lock mieszek-worek zbiorczy o długości 6cm
 3. Worek zbiorczy:
 - pojemność 500ml
 - skalowany co 50ml
 - łącznik Large-Lock
 - tylna ściana biała w celu łatwiejszej wizualizacji treści
 - zastawka antyzwrotna i zawór spustowy typu T
 4. Dren Redona 100% silikon:
 - długość 50 cm
 - trokar ze stali nierdzewnej
 - linia kontrastująca RTG
 - perforacja na odcinku 15 cm
- Zestaw sterylny - sterylizowany tlenkiem etylenu
 - Pakowany podwójnie:
 - opakowanie zewnętrzne: papier/folia
 - opakowanie wewnętrzne: folia
- _____?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 12, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze 15?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 36, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści wzierniki z blokadą położenia łyżek w postaci szpilki?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 36, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?



Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem


DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
lek. med. Elżbieta Włodarczyk

- 1/ Platforma e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/>
- 2/ <https://raszeja.poznan.pl/>
- 3/ a/a