



Poznań, dnia 21.07.2026 r.

SR/XV-270-19(8)-EFK/26

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy Pzp na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
SR/XV-270-19-EFK/26

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 8

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2026, poz. 793), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 1:

1. Do umowy:

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Pakiet 1 poz.2

Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem przylepnym 7cm z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

3. Pakiet 1 poz.2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik okrągły poj. 120 ml, z podziałką?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Pakiet 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo foliowy z dodatkowo dołożonym pojemnikiem 3 komorowym, który może służyć jako blister?

1x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 10cm, przylepce na 2 rogach materiał PP+PE

1x Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2-warstwowa materiał PP+PE

10x Kompres z włókniny 30G 4W 7,5cm x 7,5cm

1x Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, samoprzylepny, rozm. 5cm x 7,2cm

1x Igła iniekcyjna (1,2 x 40 / 18G x 1½"), różowa

1x Igła iniekcyjna (0,5 x 25 / 25G x 1"), pomarańczowa

1x Pęseta plastikowa 13cm zielona

1x Strzykawka 3-częściowa 2ml Luer

1x Strzykawka 2-częściowa 5ml Luer (zielony tłok)

1x Pojemnik PP 3-komorowy 19,5cm x 13cm x 3,5cm, przezroczysty

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



5. Pakiet nr 2, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści ligninę o chłonności 12,8g/g?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

6. Pakiet nr 2, poz. 1,3 - Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana lignina w arkuszach charakteryzowała się stopniem pylenia metodą IGT równym 1 w sześciostopniowej skali? W skali tej im wyższy stopień, tym większe pylenie materiału, dlatego wartość 1 oznacza minimalne lub brak pylenia. Parametr ten ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowania wyrobu medycznego, ponieważ ogranicza uwalnianie drobnych cząstek włókien celulozowych do otoczenia, co zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia pola zabiegowego oraz poprawia bezpieczeństwo pacjenta i personelu.
W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że wymagany jest stopień pylenia metodą IGT = 1 (najniższe pylenie w skali 1–6).

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, Zamawiający dopuszcza.

7. Pakiet nr 2, poz. 4 – Czy Zamawiający wymaga aby podkład dla dzieci posiadał kolorowy nadruk na warstwie spodniej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, Zamawiający dopuszcza.

8. Pakiet nr 2, poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'15szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

9. Pakiet nr 2, poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

10. Pakiet nr 2, poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści podkłady ginekologiczne o poniższym składzie?

opis części składowej wyrobu	funkcja części	materiał /surowiec	kolor
warstwa kontaktowa z raną	część bezpośrednio stykająca się z raną zapewniająca przejście wysięku do rdzenia opatrunku oraz bezbolesną zmianę opatrunku	100% włóknina ES (etylenowo-propylenowa)	biały
warstwa otaczająca wkład chłonny	część otaczająca wkład chłonny	100% celuloza	biały
wkład chłonny	część pochłaniająca (absorbująca) nadmiar wysięku, krwi, płynów ustrojowych z ran	wata bawełniana SAP – poliakrylan sodu grubość: 1,5 cm chłonność ≥ 280ml	biały
warstwa spodnia	część nieprzemakalna, zapobiega przesiąkaniu opatrunku	folia PE	różowy
zewnątrzna część przylepna	umożliwia zamocowanie opatrunku	klej	przeźroczysty
papier zabezpieczający	ochrona części lepnej	papier	biały

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

11. Pakiet nr 2, poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści podkłady ginekologiczne z możliwością sterylizacji tlenkiem etylenu?

Telefony: centrala 61-22-45-211; sekretariat 61-22-45-233; fax. 61-848-49-90

NIP 781-16-19-837 REGON 000313325

KONTO: PKO BP I O/Poznań nr 20 1020 4027 0000 1902 0049 2777



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

12. Pakiet nr 2, poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści serwety 8 warstwowe?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

13. Pakiet nr 2, poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

14. Pakiet nr 2, poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

15. Pakiet nr 2, poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

16. Pakiet nr 2, poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści serwety niejałowe pakowane po 20szt. oraz wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

17. Pakiet nr 2, poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

18. Pakiet nr 2, poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

19. Pakiet nr 6, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190 cm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

20. Pakiet nr 6, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² zintegrowane z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami



- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190 cm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

21. Pakiet 6 poz.3

Czy Zamawiający dopuści serwetę 230 x 300cm z otworem samouszczelniającym się o śr 7cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

22. Pakiet 6 poz.3

Czy Zamawiający dopuści serwetę gazową 45 x 70 cm, 6-warstwowa, 17-nitkowa?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

23. Pakiet 6 poz.3

Czy Zamawiający dopuści obłożenie wykonane z dwuwarstwowego laminatu (folia PE + włóknina PP), posiada wzmocnienie w strefie krytycznej z włókniny SM o gramaturze 80g/m². Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 197cm H₂O, odporność na rozerwanie w strefie wzmocnionej na sucho/mokro 172/180 kPa?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

24. Pakiet 6 poz.4

Czy Zamawiający dopuści serwetę do laparoskopii 200/270cm x 300cm 2-warstwowa wzmocniona, osłony na kończyny, przylepny otwór 25cm x 30cm, organizery przewodów wykonany z materiału PP+PE o gramaturze 60g/m² ze wzmocnieniem z materiału SM o gramaturze 80g/m², wypychanie na sucho/mokro 110/100 kPa, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

25. Pakiet 6 poz.4

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania pola operacyjnego (dł. 300cm, CH24, lejek-lejek)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

26. Pakiet 6 poz.4

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo Serweta 80cm x 145cm wzmocnienie o wymiarach 75cm x 90cm folia PE 50 g/m² + wzmocnienie w strefie krytycznej: włóknina PP 100g/m², pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

27. Pakiet 6 poz.4

Czy Zamawiający dopuść fartuch chirurgiczny Comfort o gramaturze 68g/m² rękawy w kolorze białym w rozmiarze XL, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



28. Pakiet 6 poz.4

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik instrumentalny w rozmiarze 150cm x 190cm wykonanej z folii PE 40 g/m² + wzmocnienie w strefie krytycznej: włóknina PP 37 g/m², pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

29. Pakiet 6 poz.5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²:

- 1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

30. Pakiet 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kieszeń w rozmiarze 50x50 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

31. Pakiet 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kieszeń wykonaną z przeźroczystej folii polietylenowej 0.065 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

32. Pakiet 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kieszeń w rozmiarze 30x40?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.


33. Pakiet 9, poz.1 – Czy Zamawiający w miejsce opisanego zestawu dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, obszar chłonny 65 x 190 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm, wykonana z włókniny spunlace 68g/m²
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze SM o gramaturze 80 g/m².

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

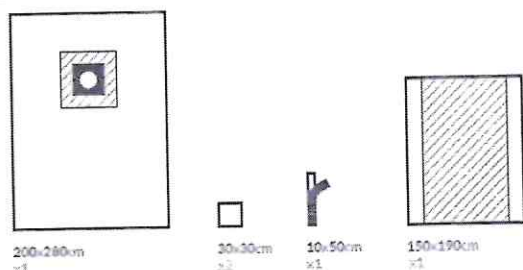


Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

34. Pakiet 9, poz.1 – Czy Zamawiający w miejsce opisanego zestawu dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 200 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 6 cm x 65 cm
 - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
 - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
 - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 65 x 190 cm
 - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm, włóknina spunlace 68g/m²
 - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
 - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze SM o gramaturze 80 g/m².

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

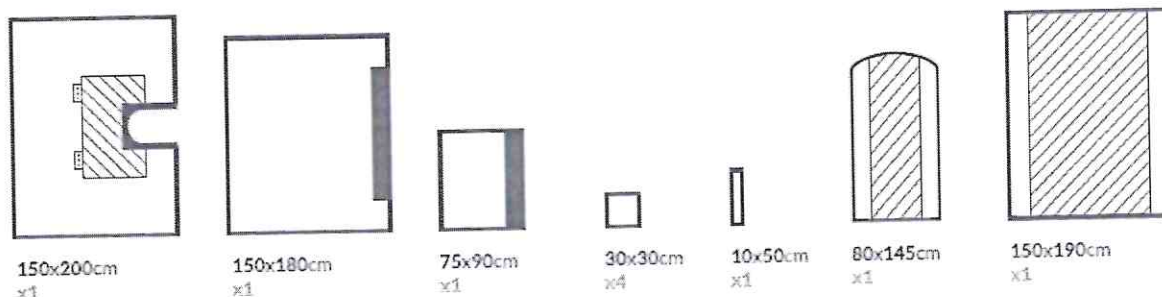

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

35. Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z laminatu o gramaturze 60 g/m², z warstwą włókniny pochłaniającej wysięk i warstwą folii zapobiegającej przemakaniu. Zaopatrzona w otwór o oś 10 cm x 15 cm otoczony taśmą samoprzylepną 15 x 20 oraz w dodatkowe przylepce 5 x 5 umiejscowione na każdym rogu serwet, ułatwiające aplikację.



Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

36. Pakiet nr 10, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozmiarze 75 x 90 cm do znieczulenia przewodowego z centralnie położonym otworem przylepnym 10 x 15 cm, otoczonym warstwą przylepną 15 cm x 20 cm, serweta posiada dodatkowo 4 przylepce 5 x 5 cm na rogach serwety. Opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Odporność na przenikanie cieczy 196 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 109/99,4 kPa, chłonność 600%. Serweta wykonana z laminatu 2 warstwowego o gramaturze 60g/m², spełnia wymagania normy PN EN 13795 wymagania wysokie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

37. Pakiet nr 10, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozmiarze 150 x 190 cm na stolik instrumentariuszki, wykonaną z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej – 77 g/m². Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 108/95 kPa, chłonność 350%?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

38. Pakiet nr 10, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny wykonany z: celuloza – 2 x 18 g/m² (tj. 36g/m²), folia PE - grubość 16 +/- 1 µm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

39. Pakiet nr 10, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 33g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

40. Pakiet nr 10, poz. 5 – Czy w miejsce opisanego podkładu Zamawiający dopuści podkład o poniższym opisie?

Podkład chłonny oddychający na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225 cm z wkładem chłonnym 60 x 203cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 36 g, dwóch warstw celulozy 33,25 g, pulpy celulozowej 249,3 g z superabsorbentem SAP 30,45 g, warstwa zewnętrzna (spodnia) 117 g. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii: MRSA, E.Coli. Podkład umożliwia przenoszenie pacjenta do 230 kg. Waga całkowita podkładu 470 g ±5g, chłonność 5267,5 g; opakowanie 5 szt. Opakowanie posiada uchwyt umożliwiający przenoszenie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

41. Pakiet nr 10, poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'5szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

42. Pakiet nr 10, poz. 6 – Czy w miejsce opisanego prześcieradła Zamawiający dopuści kocik o poniższym opisie?

Termiczne okrycie pacjenta jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej 25 g/m² w kolorach zielonym i niebieskim, warstwa wewnętrzna z poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe; niepalne. Rozmiar 110 x 210 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



43. Pakiet nr 10, poz. 6 – Czy w miejsce opisanego prześcieradła Zamawiający dopuści kocyk o poniższym opisie?

Termiczne okrycie pacjenta jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z bardzo miękkiej włókniny Spunlace 40 g/m² w kolorze białym, warstwa wewnętrzna z poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe. Rozmiar 110 x 210 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

44. Pakiet nr 11, poz. 1- Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetkę chłonna o wymiarach 40cm x 40cm, wykonaną z wysokochłonnej włókniny typu spunlace o gramaturze 56 g/m², pakowaną pojedynczo?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

45. Pakiet nr 14, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

46. Pakiet nr 14, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści skalpel (ostrze z trzonkiem) ze Swanna Mortona?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei

lek. med. *Elżbieta Wrzesińska-Zak*

1/ Platforma e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/>

2/ <https://raszeja.poznan.pl/>

3/ a/a